


VARNING



- Förvara nya och använda batterier oåtkomligt för barn. Se bruksanvisningen för ytterligare information.
- Den här kom igång-guiden ersätter inte bruksanvisningen till din Accu-Chek Guide-blodsockermätare. Bruksanvisningen innehåller viktiga hanteringsanvisningar och ytterligare information.
- Blodprovstagaren är endast avsedd för personligt bruk.

ANMÄRKNING

- Ha alltid en uppsättning reservbatterier till hands.
- Batterilivslängden kan variera beroende på faktorer som till exempel temperatur och batteritillverkare.

Översikt



- Display
- Tillbakaknapp
- Uppåtpil och nedåtpil
- På/Av/Bekräfta/OK-knapp
- Plats för testremsa med belysning
- Batterilucka
- Micro-USB-port
- Testremseutmatare

Ställa in språk och tidsformat



Slå på mätaren genom att trycka kort på **Language** (Språk) visas. Tryck på **English** eller **Dansk** för att markera önskat språk. Tryck på **OK**.




Tidsformat visas. Tryck på **12-timmarstid** (am/pm = fm/em) eller **24-timmarstid**. Tryck på **OK** för att bekräfta alternativet och gå tillbaka till **Huvudmeny**.


Förbereda blodprovstagaren




Bekanta dig med Accu-Chek FastClix-blodprovstagaren.



Ta ut lansettrumman ur väskans ficka.



Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.




ANMÄRKNING
Varje lansettrumma innehåller 6 sterila lansetter.



Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.



Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.




Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.




Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.




Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.



Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.



Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.



Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.



Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.



Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.




Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.



Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.



Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.




Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.




Ta bort kåpan genom att dra den rakt av. Vrid inte kåpan.

Utföra ett blodsockertest




Tvätta och torka händerna innan du utför ett blodsockertest.




Kontrollera utgångsdatumet på testremseburken. Använd inte testremsor med passerat utgångsdatum.




Ta ut en testremsa ur testremseburken. Förslut testremseburken väl.



Sätt in testremsans metallfärgade ände i mätaren.



Mätaren slås på. **Förbereder test** visas.



Mätaren slås på. **Förbereder test** visas.




Mätaren slås på. **Förbereder test** visas.



Mätaren slås på. **Förbereder test** visas.



Mätaren slås på. **Förbereder test** visas.



Mätaren slås på. **Förbereder test** visas.




Mätaren slås på. **Förbereder test** visas.



Mätaren slås på. **Förbereder test** visas.



Mätaren slås på. **Förbereder test** visas.



Mätaren slås på. **Förbereder test** visas.


SENASTE REVIDERING: 2019-08

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE och FASTCLIX är varumärken som tillhör Roche.

© 2019 Roche Diabetes Care
08099235050-0819
08099235050(02)-0819

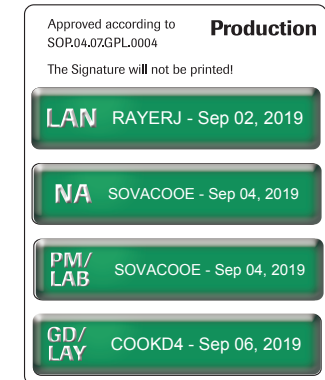

PMS-QUICK START GUIDE

Aloita tästä

Aloituspapas



VAARA



• Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Lisätietoa on käyttöohjeessa.

- Tämä aloitusopas ei korvaa Accu-Chek Guide -verensokerimittarin käyttöohjetta. Käyttöohje sisältää tärkeitä käsittelyohjeita ja lisätietoja.
- Lansettikynä on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.

HUOMAUTUS

- Pidä varapariistoja aina saatavilla.
- Pariston käyttöikään vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten lämpötila ja paristojen valmistaja.

Yleiskuva



- 1 Näyttö
- 2 Peruutusnäppäin
- 3 Nuolinäppäimet ylös ja alas
- 4 Virta-/asetus-/OK-näppäin
- 5 Valaistu testiliuskanpidike
- 6 Paristokotelon kansi
- 7 Micro-USB-portti
- 8 Testiliuskan vapautin

Kielen ja kellonajan muodon asettaminen



Käynnistä mittari painamalla lyhyesti **Language** (Kieli). Korosta haluamasi kieli painamalla tai **OK**. Paina **OK**.




Näyttöön ilmestyy **Ajan muoto**. Korosta **12 tuntia** (am/pm) tai **24 tuntia** painamalla tai **OK**. Vahvista valintasi ja palaa **Päävalikko**-näyttöön painamalla **OK**.

Lansettikynän valmistelemine




Tutustu Accu-Chek FastClix -lansettikynään.



Ota lansettirulla kuljetuskotelon taskusta.



HUOMAUTUS
Jokainen lansettirulla sisältää 6 steriiliä lansettia.




Irrota kärkiosa suoraan vetämällä. Älä kierrä kärkiosaa.




VAARA
Lansettirullaa ei saa asettaa lansettikynään samanaikaisesti, kun laukaisupainiketta painetaan, tai kun lansettikynän laukaisupainike on tuettuna esim. pöytää vasten. Muutoin lansetti voi mahdollisesti lauaeta ja pistää tahattomasti.




Aseta lansettirulla valkoinen osa edellä lansettikynään. Työnä lansettirullaa, kunnes se loksahdaa kunnolla paikalleen.



HUOMAUTUS
Älä irrota lansettirullaa ennen kuin kaikki 6 lansettia on käytetty, sillä kun lansettirulla on irrotettu lansettikynästä, sitä ei voi enää käyttää.



Aseta lansettikynän kärkiosa takaisin paikalleen. Varmista, että kärkiosan lovi osuu lansettikynän syvennyksessä olevaan keskikohtaan.




Säädä lansetin pistosvyys sopivaksi. Valitse aluksi 2. Valitse paksummalle iholle suurempi luku.




Kun olet valmis mittaamaan...

Verensokerin mittaaminen




Pese ja kuivaa kätesi ennen verensokerin mittaamista.



Tarkista viimeinen käyttö-päivämäärä testiliuskapurkin kyljestä. Älä käytä vanhentuneita testiliuskoja.




Ota testiliuska testiliuska-purkista. Sulje testiliuskapurkki tiiviisti.




Aseta testiliuskan metallin-värinen pää mittariin.



Mittari käynnistyy. Näyttöön ilmestyy **Mittausta valmistellaan**.




Paina lansettikynä napakasti sormenpään reuna-alueelle ja paina laukaisupainiketta, jolloin lansetti pistää ihoon.



Kosketa veripisaraa testiliuskan **keltaisella reunalla**. Poista sormi testiliuskalta, kun näyttöön ilmestyy **Analysoidaan**. Älä aseta verta testiliuskan päälle.



Mittaustulos ilmestyy näyttöön alle 4 sekunnissa.



Valmistele lansettikynä seuraavaa mittausta varten. Ota seuraava lansetti käyttöön työntämällä vipua kerran edestakaisin. Lansettikynässä oleva näyttö osoittaa käytettävissä olevien lansettien määrän.

Mittariisi yhteensopivan diabeteksenhallintasovelluksen voit hakea osoitteesta www.accu-chek.com.

VIIMEISIN PÄIVITYS: 2019-08

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



ACCUCHEK, ACCUCHEK GUIDE ja FASTCLIX ovat Rochen tavaramerkkejä.

© 2019 Roche Diabetes Care
08099235050-0819
08099235050(02)-0819

